

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 67000**Fecha de Recepción** (Reception Date): 2026-02-27**Fecha de Calibración** (Calibration Date): 2026-02-27**Próxima Fecha de Calibración** (Calibration Due): 2026-08**Fecha de Emisión** (Emission Date): 2026-02-27

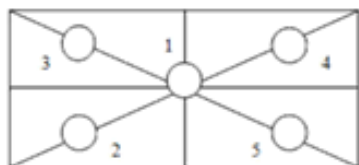
Cliente (Client): INDECAUCHO CIA. LTDA.
CAYAMBE / SAN JOSÉ DE AYORA / PANAMERICANA NORTE SN, CAYAMBE (PICHINCHA), ECUADOR

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity):	3000 kg	Ubicación: (Location):	
Marca (Brand):	Radwag	División de escala: (Resolution):	d: 0.2 kg / e: 200 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Modelo (Model):	PUE7.1	Clase (Class):	Alta (II)		
Serie (Serial #):	704406				
Código (Code):	CY-CL-048				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento** (Procedure): INN-PC-13**Condiciones Ambientales** (Environmental Conditions)**Temperatura** (Temp): (22.1 °C a 22.8 °C)**Humedad** (Humidity): (59.6 %HR a 58.7 %HR)**Trazabilidad** (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Pesas F1	Rice Lake	SECM-M-2025-123	2025-05-07	1 año
Pesas F1 (0.3 a 2) kg	Rice Lake	SECM-M-2025-119-120 -121-122	2025-05-07	1 año
Pesas F1 (10 a 20) kg	Rice Lake	NM-M-2025-183-184-185	2025-10-07	1 año
Pesas M1	-	55798	2025-04-09	1 año

Ejemplo Distribución de Excentricidad:**Cumplimiento de la balanza:**

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad:	Cumple
Linealidad:	No Cumple
Repetibilidad:	Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, U otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los resultados en # no se encuentran dentro de la acreditación de A2LA, pero si dentro de las capacidades de INNOVATEC
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 67000
Fecha de Calibración: 2026-02-27

Equipo (Instrument): Balanza
Marca (Brand): Radwag

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±) Tolerance (±)	Histéresis (Histerisis)	Incertidumbre (Uncertainty)
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente			
10 kg	10 kg	10 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
20 kg	20 kg	20 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
50 kg	50 kg	50 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
100 kg	100 kg	100 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
200 kg	200 kg	200 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
300 kg	299.8 kg	299.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
500 kg	499.8 kg	499.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
#750 kg	749.8 kg	749.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
#2000 kg	1999.6 kg	1999.6 kg	-0.4 kg	-0.4 kg	0.4 kg	0 kg	± 0.28 kg
#3000 kg	2999.4 kg	2999.4 kg	-0.6 kg	-0.6 kg	0.4 kg	0 kg	± 0.28 kg

Excentricidad:

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		
750 kg	749.6 kg	749.8 kg	749.8 kg	749.8 kg	749.6 kg	0.2 kg	0.2 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
1500 kg	1499.6 kg	0 kg	0.4 kg	3000 kg	2999.4 kg	0 kg	0.4 kg
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		
	1499.6 kg				2999.4 kg		